


# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО VIO® 3


 Краткое руководство не заменяет инструктаж и инструкцию по эксплуатации. Краткое руководство не содержит указаний по безопасности. Внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопасности, приведёнными в инструкциях по эксплуатации.

## Необходимые рабочие операции


### 1 Включить прибор

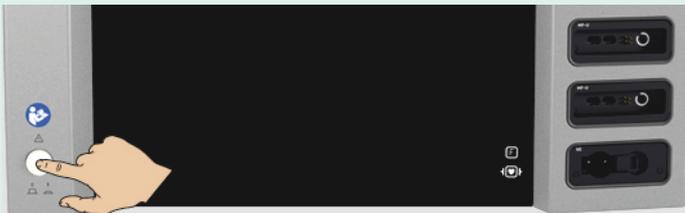

### 2 Выбрать программу

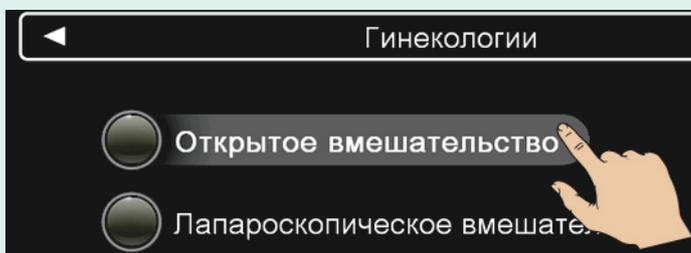

### 3 Наложить и подсоединить нейтральный электрод

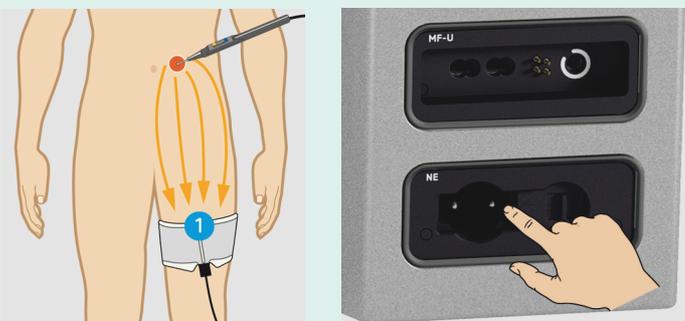

Длинный край нейтрального электрода (1) должен указывать в сторону операционного поля.


### 4 Наблюдать за нейтральным электродом




При появлении красного символа нейтрального электрода проверьте:

- нейтральный электрод правильно соединён с прибором?
- длинный край нейтрального электрода указывает в сторону операционного поля?
- нейтральный электрод имеет достаточный контакт с кожей?

### 5 Подключение инструмента

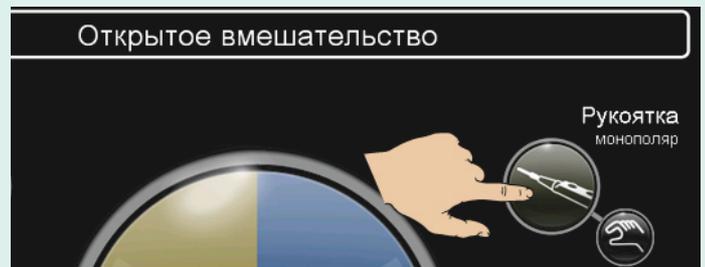

1. Коснитесь символа инструмента.

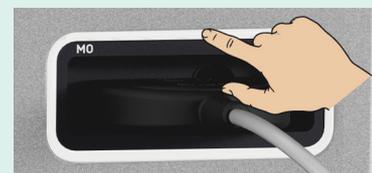

2. Подсоедините инструмент к гнезду с пульсирующей рамкой.

### 6 Проверка настроек инструмента



### 7 Открытие баллона с аргоном для режимов APC




# Факультативные рабочие операции

## 8 Изменить режим



## 10 Назначение ножного выключателя, AUTO START, AUTO STOP

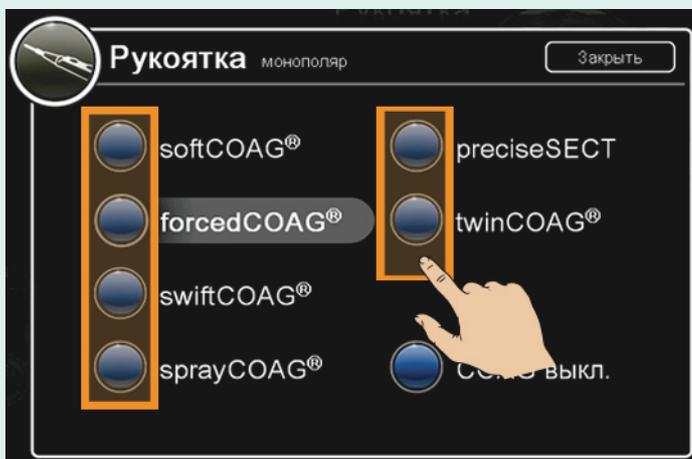

## 9 Изменить эффект

